

Åtgärda ljudproblem vid ansluten webbkamera/headset i Medspeech och Cosmic

Problem:


- Ljudet från diktatet kommer på datorns högtalare/headset och inte i diktafonen, eller att det blir webbkamerans mikrofon som blir standard vid diktering.

Så här kan användarna själva åtgärda problemet:


1. Högerklicka på ljudikonen längst ner till höger




2. Välj Ljud

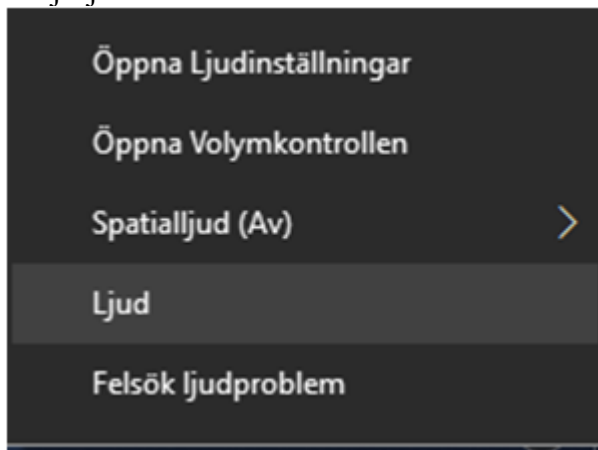

3. Under fliken "Uppspelning", sätt SpeechMike som standardenhet (högerklicka och välj "ange som standardenhet")
Säkerställ även att "Standardenhet för kommunikation" blir den enhet som man använder för att lyssna på ljudet från videomöten (viktigt för att möte i Skype ska fungera!)
(högerklicka och välj "ange som standardenhet för kommunikation")

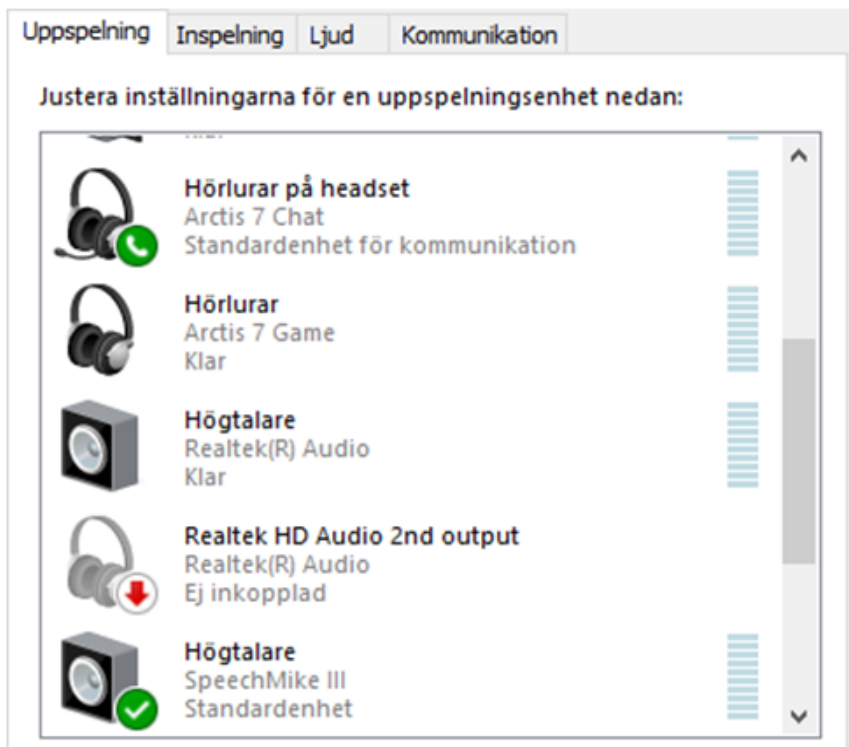

4. Under fliken "Inspelning", sätt SpeechMike som standardenhet (högerklicka och välj "ange som standardenhet")
Säkerställ även att "Standardenhet för kommunikation" blir den enhet som man använder för att spela in ljudet (prata) i videomöten (viktigt för att möte i Skype ska fungera!)
(högerklicka och välj "ange som standardenhet för kommunikation")

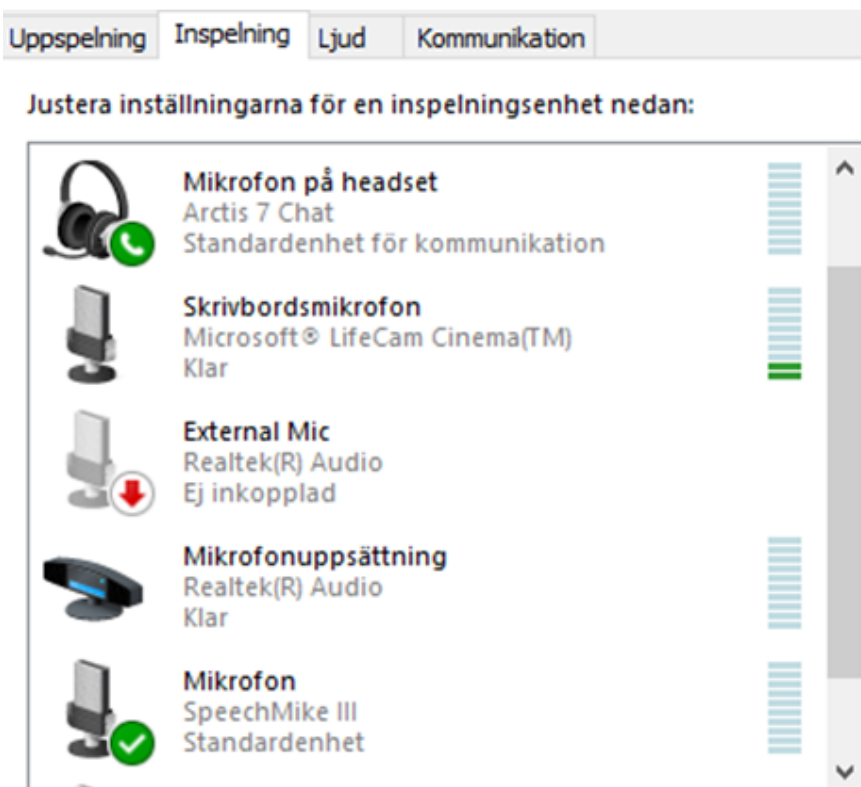

5. Bekräfta med OK
KLART!